

Руководителю филиала  
ФГБУ "Россельхозцентр"  
по Ставропольскому краю  
П.Д. Стамо

Исх. № 06 от 19.02.2016г.

Уважаемые партнеры!

От имени ООО «Сингента» благодарим Вас за участие в тестировании семян кукурузы, подсолнечника, которое проводила наша компания в октябре-ноябре 2015г. Настоящим письмом мы хотели бы сообщить о результатах тестирования семян. А именно, показать результаты, предоставленные Вашей лабораторией по сравнению с результатами других лабораторий в РФ, а также лабораторий ООО «Сингента» во Франции и Венгрии.

Компания Сингента будет принимать во внимание данные результаты в процессе работы, связанной с определением качества семян.

Анализ результатов проводился по нескольким показателям: сравнение средних значений всхожести образцов и отклонений значений от среднего, как между образцами, так и внутри каждого образца по повторностям.

В приложениях приведены данные по средним результатам всех образцов, тестируемых каждой лабораторией.

Наименования лабораторий закодированы.

При возникновении вопросов, за более детальной информацией по результатам тестирования просьба обращаться в отдел качества ООО «Сингента»

1. Приложение № 1: Результаты по оценке всхожести семян подсолнечника
2. Приложение № 2: Результаты по оценке всхожести семян кукурузы

С уважением,  
Менеджер по качеству ООО «Сингента»,  
Д. М. Мальковец



## Приложение № 1: Результаты по оценке всхожести семян подсолнечника.


Анализировались 7 образцов семян подсолнечника

Лаборатория № 00 - лаборатория ООО «Сингента» в Венгрии (методика ISTA)

Лаборатории №№ 01 – 20 - аккредитованные лаборатории Россельхозцентра и Россельхознадзора (методика ГОСТ Р)

Лаборатория № 19 - Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю

*Средний результат всхожести по всем образцам (с учетом результатов лаборатории ООО «Сингента» в Венгрии),%*

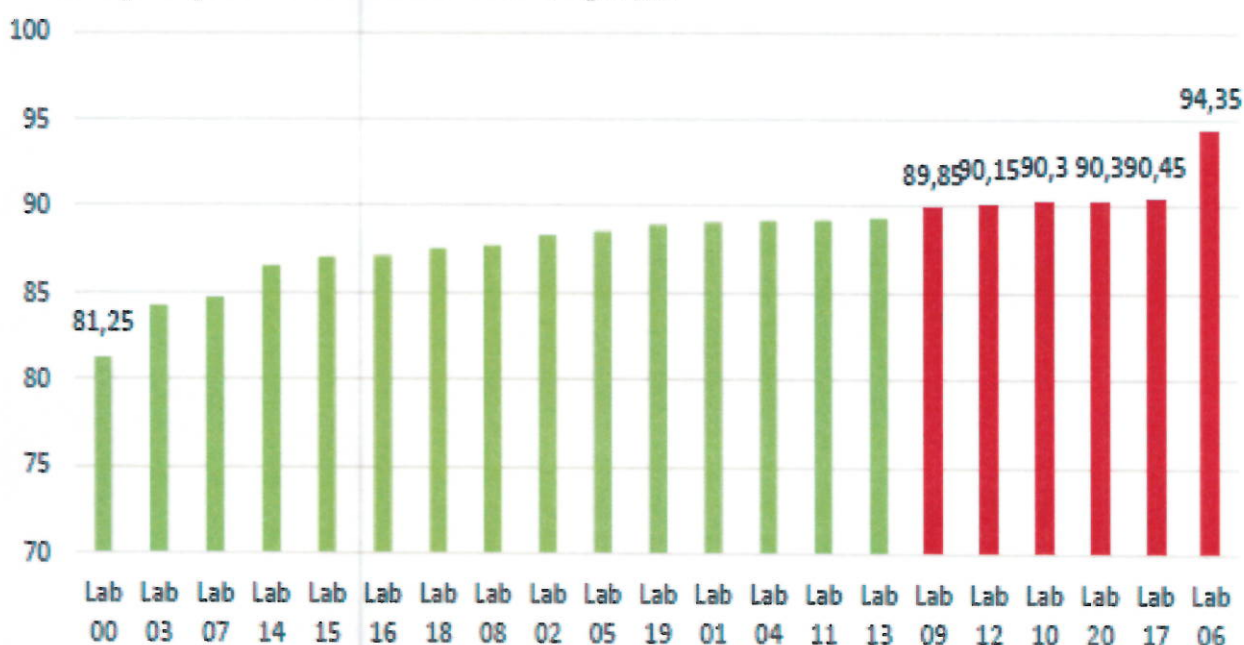

## Приложение № 2: Результаты по оценке всхожести семян кукурузы.

Анализировались 7 образцов семян кукурузы

Лаборатория № 00 - лаборатория ООО «Сингента» в Венгрии (методика ISTA)

Лаборатории №№ 01 – 20 - аккредитованные лаборатории Россельхозцентра и Россельхознадзора (методика ГОСТ Р)

Лаборатория № 19 - Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю

*Средний результат всхожести по всем образцам (с учетом результатов лаборатории ООО «Сингента» в Венгрии),%*

